



TERMO DE JUNTADA **DILIGÊNCIA-EXEQUIBILIDADE**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.04.01.01/PE/PMC

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO PRIMÁRIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.

Através do presente Termo, JUNTO aos autos do processo administrativo epigrafado, a documentação inerente à diligência postulada, acolhida para o presente processo.

EMPRESAS:

- 1) MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -CNPJ N° 05.696.303/0001-04
- 2) M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-CNPJ N° 32.593.430/0001-50
- 3) AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS- CNPJ N° 37.885.137/0001-80





CROATÁ
PREFEITURA



**MSB COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
EPP**

CNPJ: 05.696.303/0001-04

Rua Manoel Braga, nº 573, Bairro: Caroba, Croatá-CE, CEP:62.390-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 E-mail: governodecroata@croata.ce.gov.br

Instagram / facebook: [governomunicipaldecroata](https://www.facebook.com/governomunicipaldecroata)





FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2025.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Licitação

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025040101PE

ABERTURA: 29 / 07 / 2025 ÀS 08:30 H

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO PRIMÁRIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.

PLANILHA DEMONSTRATIVA - IMPOSTOS, LUCROS, ETC

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | MARCA | VALOR ADEQUADA | | Valor Atual COMPRA | | FRETE | R\$ | Encargos envio p/ Croatá | R\$ | ICMS antecipado sobre o produto + frete | R\$ | Aliquota Efectiva Simples nacional | Custo Administrativo + Lucro | Somatório : Aliquota + Custo Administrativo | Todo | Divisor | Cálculo | Fórmula / Divisor (VC: Valor compra / Divisor) + | |
|---------------------------------------|--|-------|----------|-------|----------------|-------------|--------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|---|-------|------------------------------------|------------------------------|---|---------|---------|---------|---|--|
| | | | | | UNIT. (R\$) | TOTAL (R\$) | UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SELADORA COM CONTROLE DE TEMPERATURA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SELADORA DE MESA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO POR TERMOSTATO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. | 4 | UNIDA DE | SEAL | 740,00 | 2.960,00 | 241,90 | 967,60 | 30% | 72,57 | 6% | 14.51 | 20% | 62,89 | 17,83% | 35,00% | 52,83% | 100,00% | 0,4717 | 662,80 | (VC / Divisor) + (frete) + (icms antec.) + (tx BLL) | |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$ | | | | | 2.960,00 | | 967,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dois mil, novecentos e sessenta reais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MARIA DO SOCORRO Assinado de forma digital por
BEZERRA DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE
VASCONCELOS:44090811368
VASCONCELOS:44090811368 Dados: 2025.07.29 17:07:00-03'00'

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos
RG 8911002027662SSPCE - CPF 440.908.113-68
Sócia-Gerente
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.696.303/001-04





Comercial Ecomed-MSB<cota06@ecommed.med.br>

RES: URGENTE!!! Solicitudão de Cotação PE 2025040101 Croatá 2

1 mensagem

rogerioalmeida@marcasdequalidade.com.br
 <rogerioalmeida@marcasdequalidade.com.br>
 Para: Comercial Ecomed-MSB <cota06@ecommed.med.br>

 26 de junho de 2025 às
 15:37

Boa tarde Bruno,

Como o item não especifica as medidas da seladora, podemos cotar dois modelos:

- Protect Seal Junior de 21 cm = 175,90
- Protect Seal Basic de 31 cm = 241,90

Marca: agir




Entrega: imediata com FRETE FOB Ribeirão Preto-SP

Pagamento: 30 dias a depender de aprovação do financeiro.

Aguardo seu pedido.

At,

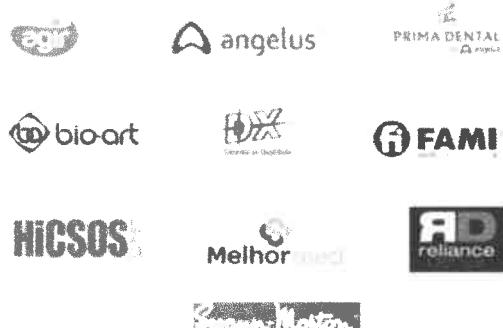

Rogério Almeida

Representante norte e nordeste
 (81)9.9976-7840 - WhatsApp
 rogerioalmeida@marcasdequalidade.com.br
 www.marcasdequalidade.com.br

De: Comercial Ecomed-MSB <cota06@ecommed.med.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de junho de 2025 14:06
Para: Rogério Almeida <rogerioalmeida@marcasdequalidade.com.br>
Assunto: URGENTE!!! Solicitudão de Cotação PE 2025040101 Croatá 2

AO

SETOR DE VENDAS

Por favor responder até o dia 04/07/2025!!!

Solicitamos a gentileza de nos enviar cotação de preço do material abaixo especificado. Favor observar características do produto e informar modelo correspondente. Enviar cotação SOMENTE se atender 100% das especificações.



► FAVOR INFORMAR:

- FRETE CIF ou FOB: ?
- SEDE DE QUEM FATURA: ?
- SE OPTANTE ou NÃO do Simples Nacional: ?
- INFORMAR CNPJ da empresa da NF: ?
- PRODUTO TRIBUTADO ou ISENTO DE ICMS: ?
- PRODUTO IMPORTADO ou NACIONAL: ?

● Enviar Catálogo / Ficha Técnica:

| ITEM | DESCRÍÇÃO | QUANT | UNID | Valor |
|------|---|-------|---------|-------|
| 5 | SELADORA COM CONTROLE DE TEMPERATURA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SELADORA DE MESA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO POR THERMOSTATO. POSSUI AÇIONAMENTO MANUAL. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. | 4 | UNIDADE | |

Bruno Menezes

Departamento Comercial
 Ecomed Comercial Médica Odontológica Ltda
 CNPJ: 00.284.181/0001-25 / CGF: 06.927.962-4
 MSB Comércio e Representações Ltda Epp CNPJ:
 05.696.303/0001-04 / CGF: 06.679.804-3
 email: cota04@ecommed.med.br
 Telefone: (85) 3270.41.00 / Celular (85) 9683.1616



CROATÁ
PREFEITURA



M. CARREGA COMÉRCIO
DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Rua Manoel Braga, nº 573, Bairro: Caroba, Croatá-CE, CEP:62.390-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 E-mail: governodecroata@croata.ce.gov.br

Instagram / facebook: [governomunicipaldecroata](https://www.facebook.com/governomunicipaldecroata)



Londrina, 29 de Julho de 2025.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
ESTADO DO CEARÁ

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.04.01.01/PE/PMC



LondriMedi
Produtos Hospitalares

PLANILHA DETALHADA DE CUSTOS - ITEM 17 - BOMBA DE INFUSÃO

| Descrição | | Valor (R\$) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Preço de custo | | R\$ 1.830,00 |
| Descrição | Percentual | Valor (R\$) |
| Frete | 5,00% | R\$ 130,00 |
| IRPJ | 1,00% | |
| CSLL | 1,00% | |
| COFINS | 3,00% | |
| PIS/PASEP | 0,50% | |
| INSS | 2,00% | |
| ICMS/ICMS Compensação | 4,00% | |
| Alíquota efetiva (IPI) | 11,50% | R\$ 299,00 |
| Custos + Despesas | | R\$ 2.259,00 |
| LUCRO | | |
| Descrição | Percentual de Lucro | Valor (R\$) |
| PREÇO DE VENDA | 15,10% | R\$ 2.600,00 |

32.593.430/0001-50

90802785-08

LONDrimedi PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
ID. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

Assinado de forma digital por JOSE
MARCIO CARREGA:10952329832

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595 - ALPES
CEP. 86.075-000 LONDRINA - PR
FONE: (43) 3339-1320
E-MAIL: londrimedifaturamento@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

Nº 000.007.542

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0732 5934 3000 0150 5500 1000 0075 4216 3699 1775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA 1250222912654 10/07/2025 13:53:55

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC EST DO SUBST TRIBUTO | CNPJ |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 908.02785-08 | | 32.593.430/0001-50 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOMENCLATURA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANELAS | CNPJ/CPF/IDESTRANGEIRO | DATA DE EMISSÃO |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ENDERECO | RUA DR MANOEL BORBA, 25 | BAIRRO/DISTRITO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO | PANELAS | CENTRO | 10/07/2025 |

FATURA/DUPLICATA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Ó. SOCIAL | ASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| ENDERECO | RUA JOSE CARLOS MUFATTO 1924 | MUNICÍPIO | CAMBE | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | 4 VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | | PR | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | ESPECIE | DESCRÍPCAO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMISH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|------------------|-------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 334 | BOMBA DE INFUSAO | | 90189010 | 040 | 2949 | UN | 4 | 2.600,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |



CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 282 - PREGAO ELETRONICO 04/2024
LOCAL DE COLETA: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. AMAURY DE MEDEIROS, S/N,
CENTRO - HORARIO DAS 7H30 AS 13H30 SEGUNDA A SEXTA - CONTATO: COSME
81979158093
VEND. J - 25/07/2024
isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:1472-9 C/C: 31999-6

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/07/2025, Valor Total: R\$10.400,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANELAS RUA DR MANOEL BORBA, 25 - CENTRO - PANELAS/PE

NF-e

Nº 000.007.542

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CROATÁ
PREFEITURA



AMB DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO E
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.885.137/0001-80



Linha 3 Peças de mão Alta rotação

O kit de peças de mão Dentemed é completo para as necessidades do cirurgião-dentista, com o melhor custo-benefício. Ele é composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo, e ainda conta com bolsa para transporte e óleo lubrificante de alta performance.

Peças com modelos de alta e baixa rotação com característica que atende a necessidade do cliente.



O kit é composto por:


- Alta Rotação
- Micromotor
- Peça Reta
- Contra-ângulo
- Bolsa para transporte
- Óleo lubrificante Prime Oil





As canetas Prime Led CX207-W-2, Prime CX207-W-2 PB-Push Button e Prime CX207-W-2 FG - Fr. I Grip de alta rotação da DENTEMED possuem rolamentos com esferas de cerâmica, tecnologia de microbalanceamento digital, garantindo maior vida útil à peça.



Também nas opções coloridas:
Dourado e Azul

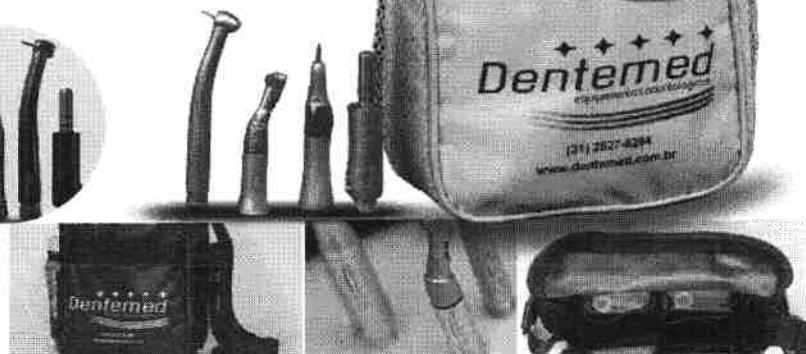

Apresentam design arrojado, são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista, além das seguintes características:

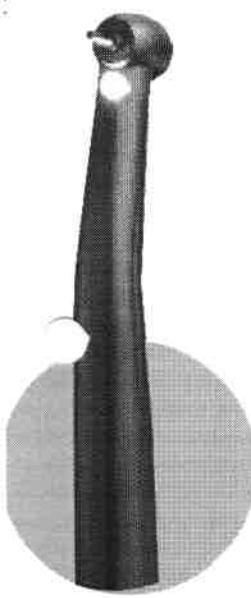

Prime CX207-W-2
FG (Friction Grip)
uso de Saca Broca
e com Spray Triplo



Prime CX207-W-2
PB (Push Button)
com Spray Triplo

Símbolos Gráficos
gravados no corpo da
caneta (NBR 9687)

Prime Led
CX207-W-2
PB (Push Button)
Gerador de luz
com Iluminação
por LED

Confeccionada conforme ISO 14457:2017 (INMETRO)

- Autoclavável até 135°C por mais de 1.000 ciclos;
- Spray triplo ventilado (03 furos) distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, projetado para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios;
- Sistema friction grip, saca-broca (tipo FG); ou
- Sistema Push Button, pressão por botão de apertar na cabeça (Tipo PB);
- Brocas em material em aço (metal duro) de Haste tipo 3 – FG Standard, diâmetro do eixo da broca: Ø1,59~1,60mm, comprimento da haste: Mínimo 9,0mm, comprimento da broca: Máximo 22,0mm, diâmetro máximo da ponta ativa – Ø2,0mm.
- Rotação com velocidade de 440.000 rpm(+/-10%) e potência até 17W;
- Alto (Extra torque) torque com 0,008 N.m.
- Rolamentos com esferas de cerâmica e turbina microbalanceada que eliminam as vibrações aumentando assim a vida útil dos rolamentos.
- Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído de 65 decibéis com alto torque;
- Produzido em material do corpo metálico, alumínio anodizado, com tratamento de superfície interno externo garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes, extremidade inclinada, peso de apenas 60g (Prime CX207-W-2 FG ou PB) e 65g (Prime Led CX207-W-2) e comprimento de 120mm;
- Cabeça padrão torque com diâmetro reduzido;
- Encaixe Bordem Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos;
- Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca;
- Pressão de ar de trabalho entre 32 PSI - 2,2 bar - 220 kpa;
- Pressão de água entre 7,25 a 29 PSI;
- Consumo de ar: 45 +/- 5 L/min;
- Consumo máxima de água: 50 ml/min.
- Gerador de luz com iluminação LED com sistema de Luz com conexão Bordem entre o gerador e o equipamento (Prime Led CX207);
- Acessórios óleo lubrificante, saca broca(FG) e borracha vedação (reserva);

Linha 3 Peças de mão Baixa rotação



Acessório (Opcional):
Lubrificante odontológico
tipo óleo mineral, spray
com adaptador para
caneta de alta e baixa
rotação, sem CFC,
embalagem de 200ml.



Apresentam design arrojado, são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista, além das seguintes características:

Contra Angulo Prime CX235-1F

- Acoplamento por sistema INTRA em aço inox com giro livre de 360° (ISO 3964);
- Sistema de spray externo, composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa, eliminando a possibilidade de entupimento e possibilitando a substituição da mangueira de passagem de água, beneficiando assepsia e evitando o risco de contaminação cruzada, refrigerando a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento da mesma;
- Velocidade com rotação mínima de 3.000 e máxima de 40.000 rpm com torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1; Torque: 0,008 N.m;
- Fabricado em liga de placa com tratamento de superfície interno e externo, corpo metálico, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Recartilha com base em sistema digital. Ângulo de 20 graus entre o longo eixo e o pescoco da cabeça, Comprimento de 89 mm e pesando apenas 43 gramas; Esterilização em autoclave até 135°C por mais de 1.000 ciclos;
- Baixo Ruido de Trabalho de 70 dB, minimizando o estresse do operador e do paciente.
- Sistema de lâmina Trava para fixação das brocas, na cabeça do contra ângulo. OU
- Sistema de troca de brocas através de pressão mecânica na cabeça da caneta, tipo Push Button;
- Utiliza Brocas de acordo com NBR ISO 1797-1-2 - Haste tipo 1 com diâmetro até 2,35mm;
- Adaptador de brocas do tipo FG permite a utilização de brocas de alta rotação, passível de uso com brocas do "TIPO AR e FG";
- Consumo máximo de ar: 45 ± 5 L/min. Pressão de ar: 0,20 MPa (2,04 kgf/cm²) – 0,22 MPa (2,24 kgf/cm²)
- Consumo máximo de água: 200 ml/min. Pressão de água: 0,05 MPa (0,5 kgf/cm²) – 0,20 MPa (2,0 kgf/cm²).

Micromotor Prime CX235-3F

- Corpo metálico, tratamento anodizado, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Comprimento de 95 mm e pesando apenas 90 gramas;
- Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de com regulagem de rotação/inversão no corpo.
- Spray interno por condução interna pelo terminal bordem e saída por nípote de encaixe para mangueira;
- Encaixe Bordem Universal (ISO 9168) com Rosca da conexão com tratamento eletroquímico;
- Velocidade com rotação de 3.000 a 23.000 rpm com transmissão de 1:1 de alto torque 0,008 N.m;
- Acoplamento por sistema INTRA (Intramatic) com giro livre de 360° (ISO 3964)
- Baixo nível de ruído (65 dB) e vibração que gera menos estresse para o dentista e paciente;
- Esterilização em autoclave até 135°C a 2,2 bar por mais de 1.000 ciclos.
- Consumo máximo de ar: 60 L/min. Pressão de ar: 0,20 MPa (2,04 kgf/cm²) – 0,22 MPa (2,24 kgf/cm²)
- Consumo máximo de água: 200 ml/min. Pressão de água: 0,05 MPa (0,5 kgf/cm²) – 0,20 MPa (2,0 kgf/cm²).
- Acompanhado de borracha de vedação da conexão e/ou óleo lubrificante.

Peca Reta Prime CX235-2A

- Corpo metálico, tratamento anodizado, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Comprimento de 84 mm e pesando apenas 43 gramas;
- Peça reta com sistema de troca brocas por fecho por giro de anel compatível Haste tipo 2 com diâmetro entre 2,334mm e 2,35mm;
- Acoplamento por sistema INTRA (Intramatic) com giro livre de 360° (ISO 3964)
- Spray único externo: direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho;
- Esterilização em autoclave até 135°C por mais de 1.000 ciclos;
- Velocidade com rotação entre 3.000 a 40.000 rpm com transmissão de 1:1 por um conjunto eixo e engrenagens;

PB - Push Button ou LT - Lâmina Trava





ABO RECOMENDA

SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE CONCESSÃO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00, Rua Antônio Gravatá, 136-A - Cinquentenário - CEP: 30570-040 - Belo Horizonte - MG, licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produto:

KIT PEÇAS DE MÃO DENTEMED
(ALTA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO - PEÇA RETA E MICROMOTOR)

A handwritten signature in black ink, enclosed in a decorative oval border.

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação
Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

DATA: OUT/2022

VAL: OUT/2024



DIFERENCIAIS APROVADOS

SELO DE QUALIDADE

DIFERENCIAIS APROVADOS



- 1- Sistema de balanceamento computadorizado da turbina e rolamentos, garantindo alta confiabilidade para uso das brocas;
- 2- Peças leves, ergonômicas a anatômicas. Proporcionando conforto e segurança para o paciente, e melhor usabilidade do dentista;
- 3- Totalmente autoclaváveis;
- 4- Sistema de troca de broca por Push Button, proporcionando rapidez, velocidade e qualidade na troca/-substituição das brocas;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulo Henrique de Faria'.

Presidente ABO Nacional

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulo Henrique de Faria'.





LAUDO TÉCNICO SELO ABO RECOMENDA

Empresa: Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA
CNPJ: 07.897.039/0001-00

Motivo: Concessão - SELO ABO RECOMENDA

Produto: Kit Peças de Mão Dentemed (Alta Rotação – Contra Ângulo – Peça Reta e Micromotor)

Atesto que as avaliações em epígrafe foram julgadas por três comissões: Técnica; Comercial e Administrativo, *in loco*. As análises foram realizadas com o Projeto Executivo da ABO Nacional, que facilita o mérito do SELO ABO RECOMENDA a empresas dos setores de: Médicos - Odontológicos - Fármacos - Consumíveis - Comestíveis (Zero Açúcares) & Associados, em consonância com as normas do setor, especificações técnicas, recomendações de mercado e de profissionais, questionário dos diferenciais do objeto em questão, condições técnicas, material de embalagem e *merchandising*, manual do produto, *status* de aprovação pela ANVISA, informações técnicas divulgadas no Diário Oficial, regulamentação de órgãos, cronograma interno de julgamento e outros parâmetros (se houver) para compor a RATIFICAÇÃO e CHANCELA a que a entidade se propõe.

A Associação Brasileira de Odontologia (ABO NACIONAL) constituiu uma comissão denominada **DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos)** e validou, por meio do documento Laudo Técnico e Administrativo, sendo parte do processo de recomendação dirigida pela entidade e também pelo Certificado de Recomenda, que as avaliações do citado Produto / Equipamentos encontram-se:

100 % CONCLUÍDAS e APROVADAS.

São Paulo, 27 de outubro 2022.

Comissão - DAPO

DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos)

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto

| | |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| CNPJ | 07.897.039/0001-00 |
| Autorização | 8.03.496-0 |
| Produto | PEÇAS DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO DENTEMED |

Modelo Produto Médico

Prime CX207-FG

PRIME CX207-W-2

PRIME LED CX207-W-2

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|---|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual do Usuário - Peça de Mão de Alta Rotação Dentemed - REV02 23.03.2023.pdf | 0374449236 - 14/04/2023 08:08:01 |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Técnico | Instrumentos de Mao Odontologicos |
| Registro | 80349600009 |
| Processo | 25351688102201911 |
| Fabricante Legal | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| Situação | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação | [sem dados cadastrados] |

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto

| | |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| CNPJ | 07.897.039/0001-00 |
| Autorização | 8.03.496-0 |
| Produto | PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO DENTEMED |

Modelo Produto Médico

PEÇA RETA PRIME CX235-2A

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|---|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual do Usuário - P. Mão de Baixa Rotação Dentemed - Peça Reta - REV00 01.12.19.pdf | 0365458236 - 12/04/2023 10:13:03 |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Técnico | Instrumentos de Mao Odontologicos |
| Registro | 80349609007 |
| Processo | 25351709425201947 |
| Fabricante Legal | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| Situação | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação | [sem dados cadastrados] |

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto

| | |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| CNPJ | 07.897.039/0001-00 |
| Autorização | 8.03.496-0 |
| Produto | PEÇAS DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO DENTEMED |

Modelo Produto Médico

MICROMOTOR PRIME CX235-3F

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual do Usuário - P. Mão de Baixa Rotação Dentemed - Micromotor - REV00 01.12.19.pdf | 0365449237 - 12/04/2023 10:11:01 |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Técnico | Instrumentos de Mao Odontologicos |
| Registro | 80349609006 |
| Processo | 25351709424201901 |
| Fabricante Legal | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| Situação | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação | [sem dados cadastrados] |

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto

| | |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| CNPJ | 07.897.039/0001-00 |
| Autorização | 8.03.496-0 |
| Produto | peças de mão de baixa rotação dentemed |

Modelo Produto Médico

CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|---|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual do Usuário - P. Mão de Baixa Rotação Dentemed - Contra Ângulo - REV00 28.11.19.pdf | 0365426237 - 12/04/2023 10:08:37 |

| | |
|------------------------|--|
| Nome Técnico | Instrumentos de Mao Odontologicos |
| Registro | 80349609005 |
| Processo | 25351709426201991 |
| Fabricante Legal | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |
| Situação | [sem dados cadastrados] |
| Data de Publicação | [sem dados cadastrados] |



BRASIL



www

Sites de
InteresseMaps
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

----- Site do Inmetro -----

INMETRO

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

FLS. N°: 522

VISTO

SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



voltar

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NORISK Nº Certificado: 19060 Tipo: Produto Emissão: 25/11/2019 Validade: 25/11/2024**Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|--|---------------|---|--|------------------------|
| 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | RUA ANTONIO GRAVATA, 136 -- BETÂNIA - BELO HORIZONTE, MG | ATIVO | FABRICANTE - BRASIL |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | | ▼ Importado | ▼ Descrição | |
| DENTEMED | PRIME CX207-FG | | NÃO | PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO PNEUMÁTICA | |
| DENTEMED | PRIME CX207-W-2 E PRIME LED CX207-W-2 | | NÃO | PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO PNEUMÁTICA. | |



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificado de Conformidade

n.º 19060



| | |
|--------------------------------------|--|
| Produto: | Peça de mão odontológica de alta rotação pneumática. |
| Marca: | Dentemed. |
| Modelo: | Prime CX207-W-2, Prime LED CX207-W-2 e Prime CX207-FG. |
| Solicitante: | <p>Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00.</p> |
| Fabricante: | <p>Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00.</p> |
| Fabricante legal: | Não aplicável |
| Fabricante contratado: | Não aplicável |
| Regulamentos: | <p>Portaria Inmetro n. 384 de 18/12/2020. Instrução normativa da ANVISA, n. 116 de 21/12/2021.</p> |
| Modelo de certificação: | 5 |
| Normas técnicas: | ISO 14457:2017 |
| Processo de origem: | 18145-A1 |
| Data de aceite da proposta: | 07/06/2019 |
| Data de realização da auditoria: | 09 e 10/10/2019 |
| Características técnicas do produto: | <p><u>Prime CX207-W-2:</u> Torque: 0,008 N.m. Tipo de broca (ISO 1797): tipo 3. Tipo de mandril: botão. Número de sprays: 3.</p> <p><u>Prime LED CX207-W-2:</u> Torque: 0,008 N.m. Tipo de mandril: botão.</p> |

Data de emissão: 25/11/2019.

Data da revisão: 13/04/2023.

Válido até: 25/11/2024.

FQ 24 – rev.12

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19060



Iluminação: LED.
Tipo de broca (ISO 1797): tipo 3.
Número de sprays: 3.
Prime CX207-FG:
Torque: 0,008 N.m.
Tipo de broca (ISO 1797): tipo 3.
Tipo de mandril: saca broca.
Número de sprays: 3.



Versão do software:

Não aplicável

Manual do usuário:

Peças de Mão de Alta Rotação Dentemed – Revo2

RMP:

RMP ARPR, Rev. 01 – 12/04/2023

1. Acessórios e partes ensaiadas com o produto:

Agulha para limpeza

Chave de inserto

Chave saca broca

2. Relatórios de ensaios:

| Laboratório | Norma | Relatório | Emissão |
|--|----------------|------------|------------|
| Guangzhou Medical Instruments Quality Surveillance and Inspection Center of State Food and Drug Administration | ISO 14457:2017 | RZ18060001 | 01/03/2018 |

Data de emissão: 25/11/2019.
Data da revisão: 13/04/2023.
Válido até: 25/11/2024.

FQ 24 – rev.12

| | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
| No Risk STE | Certificado de Conformidade | Certificado de Conformidade |
| | n.º 19060 | OCPI0114 |



3. Histórico de revisões:

| Rev. | Descrição | Data |
|------|---|------------|
| 0 | Emissão Inicial | 25/11/2019 |
| 1 | Exclusão de informação do campo "Características técnicas do produto" | 16/01/2020 |
| 2 | Alteração da revisão do manual | 11/05/2022 |
| 3 | Inclusão de produto na família, alteração da revisão do manual, alteração da revisão do RMP, atualização da portaria e instrução normativa e inclusão de acessório. | 13/04/2023 |

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, conforme previsto no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos certificados do Inmetro (<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp>).

NO RISK – Serviços Técnicos Especializados Ltda.
Acreditação Cgcre OCP n.º 0114
 Rua Paulo Honorato Soares, 125 – Distrito Industrial –
 Cândido Mota / SP
 (18)- 3341-2281
www.noriskste.com.br

Alessandro C. Marroni
 Diretor

Data de emissão: 25/11/2019.
 Data da revisão: 13/04/2023.
 Válido até: 25/11/2024.

FQ 24 – rev.12



BRASIL



INMETRO

WWW



Sites de

Interesse

Mapa

do Site

Ouvidoria

Fale com

o INMETRO

----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NORISK Nº Certificado: 19065 Tipo: Produto Emissão: 03/12/2019 Validez: 03/12/2024**Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|--|---------------|--|---|------------------|
| 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | RUA ANTONIO GRAVATA, 136 BETÂNIA - BELO HORIZONTE, MG - BRASIL | ATIVO | FABRICANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | | ▼ Importado | ▼ Descrição | |
| DENTEMED | PRIME CX235-3F | | NÃO | PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICA - MICROMOTOR | |



Nova Pesquisa


[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19065

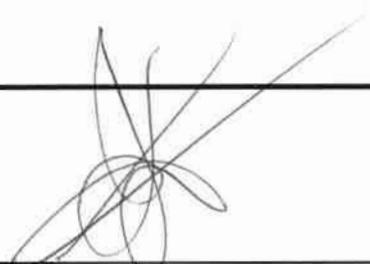

| | |
|--|--|
| Produto: | Peça de mão odontológica de baixa rotação pneumática – Micromotor. |
| Marca: | Dentemed. |
| Modelo: | Prime CX235-3F. |
| Solicitante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante legal: | Não aplicável. |
| Fabricante contratado: | Não aplicável. |
| Regulamentos: | Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares. Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. |
| Modelo de certificação: | 5 |
| Normas técnicas: | ISO 14457:2017. |
| Processo de origem: | 18145-A4. |
| Data de aceite da proposta: | 07/06/2019. |
| Data de realização da auditoria: | 09 e 10/10/2019. |
| Características técnicas do produto: | <p><u>Prime CX235-3F:</u> Torque: 0,008 N.m. Tipo de broca (ISO 1797): tipo 1. Tipo de acoplamento (ISO 3964): tipo 1.</p>  |

Data de emissão: 03/12/2019.

Data da revisão: 14/01/2020.

Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19065



| | |
|------------------------|--|
| Versão do software: | Tipo de acoplamento (ISO 9168): tipo 1 – 2 furos. Não aplicável. |
| Manual do usuário: | Peças de Mão de Baixa Rotação Dentemed – Micromotor, Rev.00, 10 páginas. |
| RMP: | Registro Mestre do Produto Baixa Rotação Dentemed – Rev.00 – 22.07.2019. |
| Relatório consolidado: | Não aplicável. |

1. Acessórios e partes fornecidas com o produto:

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Mangueira do spray externo | --- | --- |
|----------------------------|-----|-----|

2. Relatórios de ensaios:

| Laboratório | Norma | Relatório | Emissão |
|--|----------------|------------|------------|
| Guangzhou Medical Instruments Quality Surveillance and Inspection Center of State Food and Drug Administration | ISO 14457:2017 | RZ17060039 | 21/05/2018 |

3. Histórico de revisões:

| Rev. | Descrição | Data |
|------|---|------------|
| 0 | Emissão Inicial | 03/12/2019 |
| 1 | Exclusão de informação do campo “Características técnicas do produto” | 14/01/2020 |

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, conforme previsto no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

NO RISK – Serviços Técnicos Especializados Ltda.
Acreditação Cgcre OCP n.º 0114
Rua Dino Bordini, 109 – Parque das Indústrias – Itu / SP
(11)- 4024-6302
www.noriskste.com.br

Alessandro C. Marroni
Diretor

Data de emissão: 03/12/2019.
Data da revisão: 14/01/2020.
Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08



Site do Inmetro

[Certificados](#)[Produtos](#)[Serviços](#)[Empresas](#)[Organismos Acreditados](#)*Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada*

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)
 1 Produtos(s)
 0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NORISK Nº Certificado: 19063 Tipo: Produto Emissão: 03/12/2019 Validade: 03/12/2024**Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------|---|---------------|---|---|------------------|
| | 07897039000100 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | RUA ANTONIO GRAVATA, 136 -- BETÂNIA - BELO HORIZONTE, MG - BRASIL | ATIVO | FABRICANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | | ▼ Importado | ▼ Descrição | |
| DENTEMED | PRIME CX235-1F | | NÃO | PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICA - CONTRA-ÂNGULO. | |



topo

[Nova Pesquisa](#)[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19063



| | |
|--------------------------------------|--|
| Produto: | Peça de mão odontológica de baixa rotação pneumática – Contra-ângulo. |
| Marca: | Dentemed. |
| Modelo: | Prime CX235-1F. |
| Solicitante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante legal: | Não aplicável. |
| Fabricante contratado: | Não aplicável. |
| Regulamentos: | Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares. Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. |
| Modelo de certificação: | 5 |
| Normas técnicas: | ISO 14457:2017. |
| Processo de origem: | 18145-A2. |
| Data de aceite da proposta: | 07/06/2019. |
| Data de realização da auditoria: | 09 e 10/10/2019. |
| Características técnicas do produto: | <i>Prime CX235-1F:</i> Torque: 0,008 N.m. Tipo de broca (ISO 1797): tipo 1. Tipo de acoplamento (ISO 3964): tipo 1. |
| Versão do software: | Não aplicável. |
| Manual do | Peças de Mão de Baixa Rotação Dentemed – Contra Ângulo Prime – Rev.00, 12 |

Data de emissão: 03/12/2019.

Data da revisão: 14/01/2020.


Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19063



VISTO

| | | |
|--------------|---|--|
| usuário: | páginas. | |
| RMP: | Registro Mestre do Produto Baixa Rotação Dentemed, Rev.00 - 22.07.2019. | |
| Relatório | Não aplicável. | |
| consolidado: | | |

1. Acessórios e partes fornecidas com o produto:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|
| Chave para remoção da broca | Bocal para inserção de lubrificação | --- |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|

2. Relatórios de ensaios:

| Laboratório | Norma | Relatório | Emissão |
|--|----------------|------------|------------|
| Guangzhou Medical Instruments Quality Surveillance and Inspection Center of State Food and Drug Administration | ISO 14457:2017 | RZ17060039 | 21/05/2018 |

3. Histórico de revisões:

| Rev. | Descrição | Data |
|------|---|------------|
| 0 | Emissão Inicial | 03/12/2019 |
| 1 | Exclusão de informação do campo "Características técnicas do produto" | 14/01/2020 |

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, conforme previsto no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

NO RISK – Serviços Técnicos Especializados Ltda.
Acreditação Cgcre OCP n.º 0114
Rua Dino Bordini, 109 – Parque das Indústrias – Itu / SP
(11)- 4024-6302
www.noriskste.com.br

Alessandro C. Marroni
Diretor

Data de emissão: 03/12/2019.
Data da revisão: 14/01/2020.
Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08



BRASIL



INMETRO

www.



@

Sites de

Interesse

Mapa

do Site

Cuidados

Fale com

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



voltar

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

Página 1

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Certificador: NORISK Nº Certificado: 19064 Tipo: Produto Emissão: 03/12/2019 Validade: 03/12/2024**Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo**

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|--|---------------|--|---|------------------|
| 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | RUA ANTONIO GRAVATA, 136 - BETÂNIA - BELO HORIZONTE, MG - BRASIL | ATIVO | FABRICANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | | ▼ Importado | ▼ Descrição | |
| DENTEMED | PRIME CX235-2A | | NÃO | PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICA - PEÇA RETA. | |




Nova Pesquisa

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)

No Risk STE

Certificado de Conformidade

n.º 19064

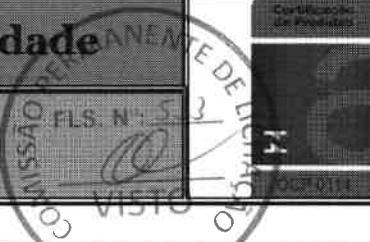

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produto: | Peça de mão odontológica de baixa rotação pneumática – Peça reta. |
| Marca: | Dentemed. |
| Modelo: | Prime CX235-2A. |
| Solicitante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante: | Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda. Rua Antônio Gravatá, n. 136 – Betânia, Belo Horizonte, MG. CEP.: 30.570-040. CNPJ.: 07.897.039/0001-00. |
| Fabricante legal: | Não aplicável. |
| Fabricante contratado: | Não aplicável. |
| Regulamentos: | Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares. Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. |
| Modelo de certificação: | 5 |
| Normas técnicas: | ISO 14457:2017. |
| Processo de origem: | 18145-A3. |
| Data de aceite da proposta: | 07/06/2019. |
| Data de realização da auditoria: | 09 e 10/10/2019. |
| Características técnicas do produto: | <u>Prime CX235-2A:</u> Torque: 0,008 N.m. Tipo de broca (ISO 1797): tipo 1. Tipo de acoplamento (ISO 3964): tipo 1. |
| Versão do software: | Não aplicável. |
| Manual do | Peças de Mão de Baixa Rotação Dentemed – Peça Reta Prime, Rev.00, 10 |

Data de emissão: 03/12/2019.

Data da revisão: 14/01/2020.

Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08

| | | |
|---|--|--|
|  | Certificado de Conformidade n.º 19064 |  |
|---|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| usuário: | páginas. | |
| RMP: | Registro Mestre do Produto Baixa Rotação Dentemed - Rev.00 - 22.07.2019. | |
| Relatório consolidado: | Não aplicável. | |
| consolidado: | | |

1. Acessórios e partes ensaiadas com o produto:

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Bocal para inserção de lubrificação. | --- | --- |
|--------------------------------------|-----|-----|


2. Relatórios de ensaios:

| Laboratório | Norma | Relatório | Emissão |
|--|----------------|------------|------------|
| Guangzhou Medical Instruments Quality Surveillance and Inspection Center of State Food and Drug Administration | ISO 14457:2017 | RZ17060039 | 21/05/2018 |

3. Histórico de revisões:

| Rev. | Descrição | Data |
|------|---|------------|
| 0 | Emissão Inicial | 03/12/2019 |
| 1 | Exclusão de informação do campo "Características técnicas do produto" | 14/01/2020 |

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, conforme previsto no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
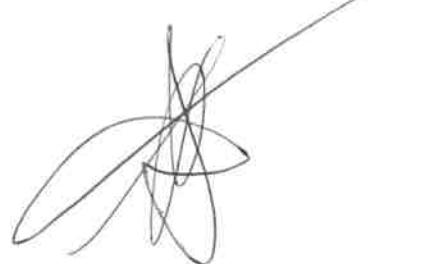
| | |
|---|---|
| NO RISK – Serviços Técnicos Especializados Ltda. Acreditação Cgcre OCP n.º 0114 Rua Dino Bordini, 109 – Parque das Indústrias – Itu / SP (11)- 4024-6302 www.noriskste.com.br |  Alessandro C. Marroni Diretor |
|---|---|

Data de emissão: 03/12/2019.
 Data da revisão: 14/01/2020.
 Válido até: 03/12/2024.

FQ 24 – rev.08

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestão para
ISO 13485:2016

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

Rua Antônio Gravatá, 136 – A – Betânia
30570-040 – Belo Horizonte – MG – Brasil

Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo

Fabricação e montagem de cadeiras odontológicas.

Número do Registro do Certificado **TNBR-25769**

Válido a partir de 10/01/2023

Válido até 14/12/2025

Certificação Inicial 2016



Reginaldo Maia
Diretor Presidente




Barueri, 10/01/2023

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.

Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br

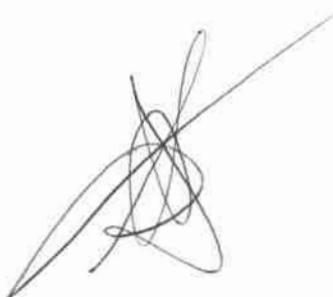

BRTUV
TÜV NORD GROUP

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestão de acordo com
ISO 9001:2015



O Organismo de Certificação TÜV NORD Brasil confirma por este meio e em resultado da auditoria, avaliação e decisão de certificação de acordo com a norma ISO/IEC 17021-1:2016, que a organização

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

Rua Antônio Gravatá, 136 - A – Betânia
30570-040 – Belo Horizonte – MG – Brasil

opera um sistema de gestão em conformidade com os requisitos da ISO 9001:2015 e será avaliado quanto à conformidade dentro do prazo de validade de 3 anos do certificado.

Escopo
Fabricação e montagem de consultórios odontológicos.

Número de Registro do Certificado **TNBR-25770**

Válido de 10/01/2023
Válido até 14/12/2025
Certificação Inicial 2016

Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 10/01/2023

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli, Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

www.brtuv.com.br



BRTUV
TÜV NORD GROUP

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | | | | | | | | |
| AMB DIST DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 4125 0237 8851 3700 0180 5500 1000 0016 1718 5422 4625 | | | | | | | | |
| AV BRASIL, 1351 VILA SALOME - CAMBE - PR CEP: 86192-000 Fone: (43)3316-6181 | | Nº 000.001.617 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250062637533 25/02/2025 09:58:22 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.17981-55 | INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | | CNPJ 37.885.137/0001-80 | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | BAIRRO/DISTrito CENTRO | | CNPJ/CPF/IDESTRANGEIRO 11.481.404/0001-60 | DATA DE EMISSÃO 25/02/2025 | | | | | | | |
| ENDERECO RUA PONTA DE AREIA, 545 | | UF BA | | CEP 45930-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2025 | | | | | | | |
| MUNICÍPIO MUCURI | | FONE/FAX (73)3206-2044 | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 09:58:20 | | | | | | | |
| FATURA/DUPLICATA 001 04/03/2025 R\$ 5.792,00 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.792,00 | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.792,00 | | | | | | | |
| NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| JAMEF TRANSPORTES LTDA | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | | | | | | | |
| ENDERECO R MIGUEL MENTEM 500 | | MUNICÍPIO SAO PAULO | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | Descrição do Produto/Serviço | | NCM/SN | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
| 2091 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO COMPBRASIL | | 84148011 | 0102 | 6102 | UN | 2 | 2.455,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2129 | CANETA BAIXA ROTACAO | | 90184999 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2360 | MICROMOTOR ODONTOLOGICO | | 84609090 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORN. 11088 / EMPENHO 1589 // PE9-204-3 LOCAL DE ENTREGA: RUA SEVERINO VIEIRA, S/N - CENTRO - PROX A IGREJA CATÓLICA - ALMOXARIFADO CENTRAL FONE AFIF ZEIDAN (73)99127-8046 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI --- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 BANCO DO BRASIL - AG: 2755-3 C/C: 40067-X OBS: Na C/C onde se le digito X e utilizado o numero 0 - CHAVE PIX: ambfinanceiro2024@gmail.com | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | |

Recebemos de AMB DIST DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:25/02/2025,Valor Total: R\$5.792,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RUA PONTA DE AREIA, 545 - CENTRO - MUCURI/BA

NF-e

Nº 000.001.617
SÉRIE: 1



Cambémed

CNPJ: 37.885.137/0001-80

Razão Social: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cambé, 30 de julho de 2025

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Croatá

REF: pe 2025040101

TIPO: MENOR PREÇO POR

Nome Fantasia: AMB DISTRIBUIDORA

Razão Social: **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede à Av. Brasil, 1351, CEP: 86181-010, Cambé/PR, Fone/Fax: (43) 3316-6181 apresenta a seguinte proposta:

PLANILHA DE CUSTOS PARA COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

| Item | Nome do Produto/Descrição | Und | Qtd | Marca | V. Unitario | V. Total | CUSTO PRODUTO | custo imposto 9,5% | custo frete 2,5% | custo operacional 4% | LUCRO FINAL |
|------|--|-----|-----|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 28 | MICRO MOTOR - DE USO ODONTOLÓGICO, ENCAIXE TIPO BORDEN, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM AJUSTAVEL NO PROPRIO INSTRUMENTO. | UND | 4 | DENTEMED / PRIME | R\$ 500,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 300,00 | R\$ 47,50 | R\$ 12,50 | R\$ 20,00 | R\$ 120,00 |
| | | | | | | R\$ 2.000,00 | | | | | |

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a este título.

Informamos e Declaramos que todos produtos oferecidos e ofertados em nossa proposta atendem todas as exigências da respectiva da lei que os rege as licitações públicas, sendo, portanto, dependendo de sua situação são análogos, similares ou de qualidade superior ao requisitado, conforme da Lei de Licitações.

Informamos que o Termo de Referência do Edital do presente certame pode conter nomes comerciais, transcrições de fabricantes específicos e direcionamentos de descritivos, portanto, DECLARAMOS que nossa proposta comercial forá elaborada considerando tais informações como REFERÊNCIA de cotação, considerando -conforme Lei- a possibilidade de aceitação de produtos **similares** contendo especificações **equivalentes ou superiores**, conforme assegurado na Lei de Licitações.

Local e Prazo de Entrega: **Conforme Edital**

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Condição de Entrega: **Conforme Edital**

Condição de Pagamento: **Conforme Edital**

Prazo de Garantia: **Conforme Edital**





Frete: **CIF (PAGO)**
Conta Bancária - Banco do Brasil AG: 27553 C/C: 39020-8
CNPJ/MF nº. 37.885.137/0001-80
Insc.Est.: Nº. 9091798155
E-mail: adm.ambcambe@gmail.com

CNPJ: 37.885.137/0001-80
Razão Social: AMB - Distribuidora de Medicamentos
e Materiais Hospitalares Ltda Nome Fantasia: Cambémed
Endereço: AV BRASIL N° 1351 CEP: 86181-000 CAMBE/PR

Cambémed

CNPJ: 37.885.137/0001-80

Razão Social: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AMB DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTO E
MATERIAIS
HOSP:37885137000180

Assinado de forma digital por
AMB DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO E MATERIAIS
HOSP:37885137000180
Dados: 2025.07.30 11:42:16
-03'00'




AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede à Av. Brasil, 1351, CEP: 86181-010, Cambé/Pr, Fone/Fax: (43) 3316-6181



MED
LIGHT

PARA TODA A VIDA

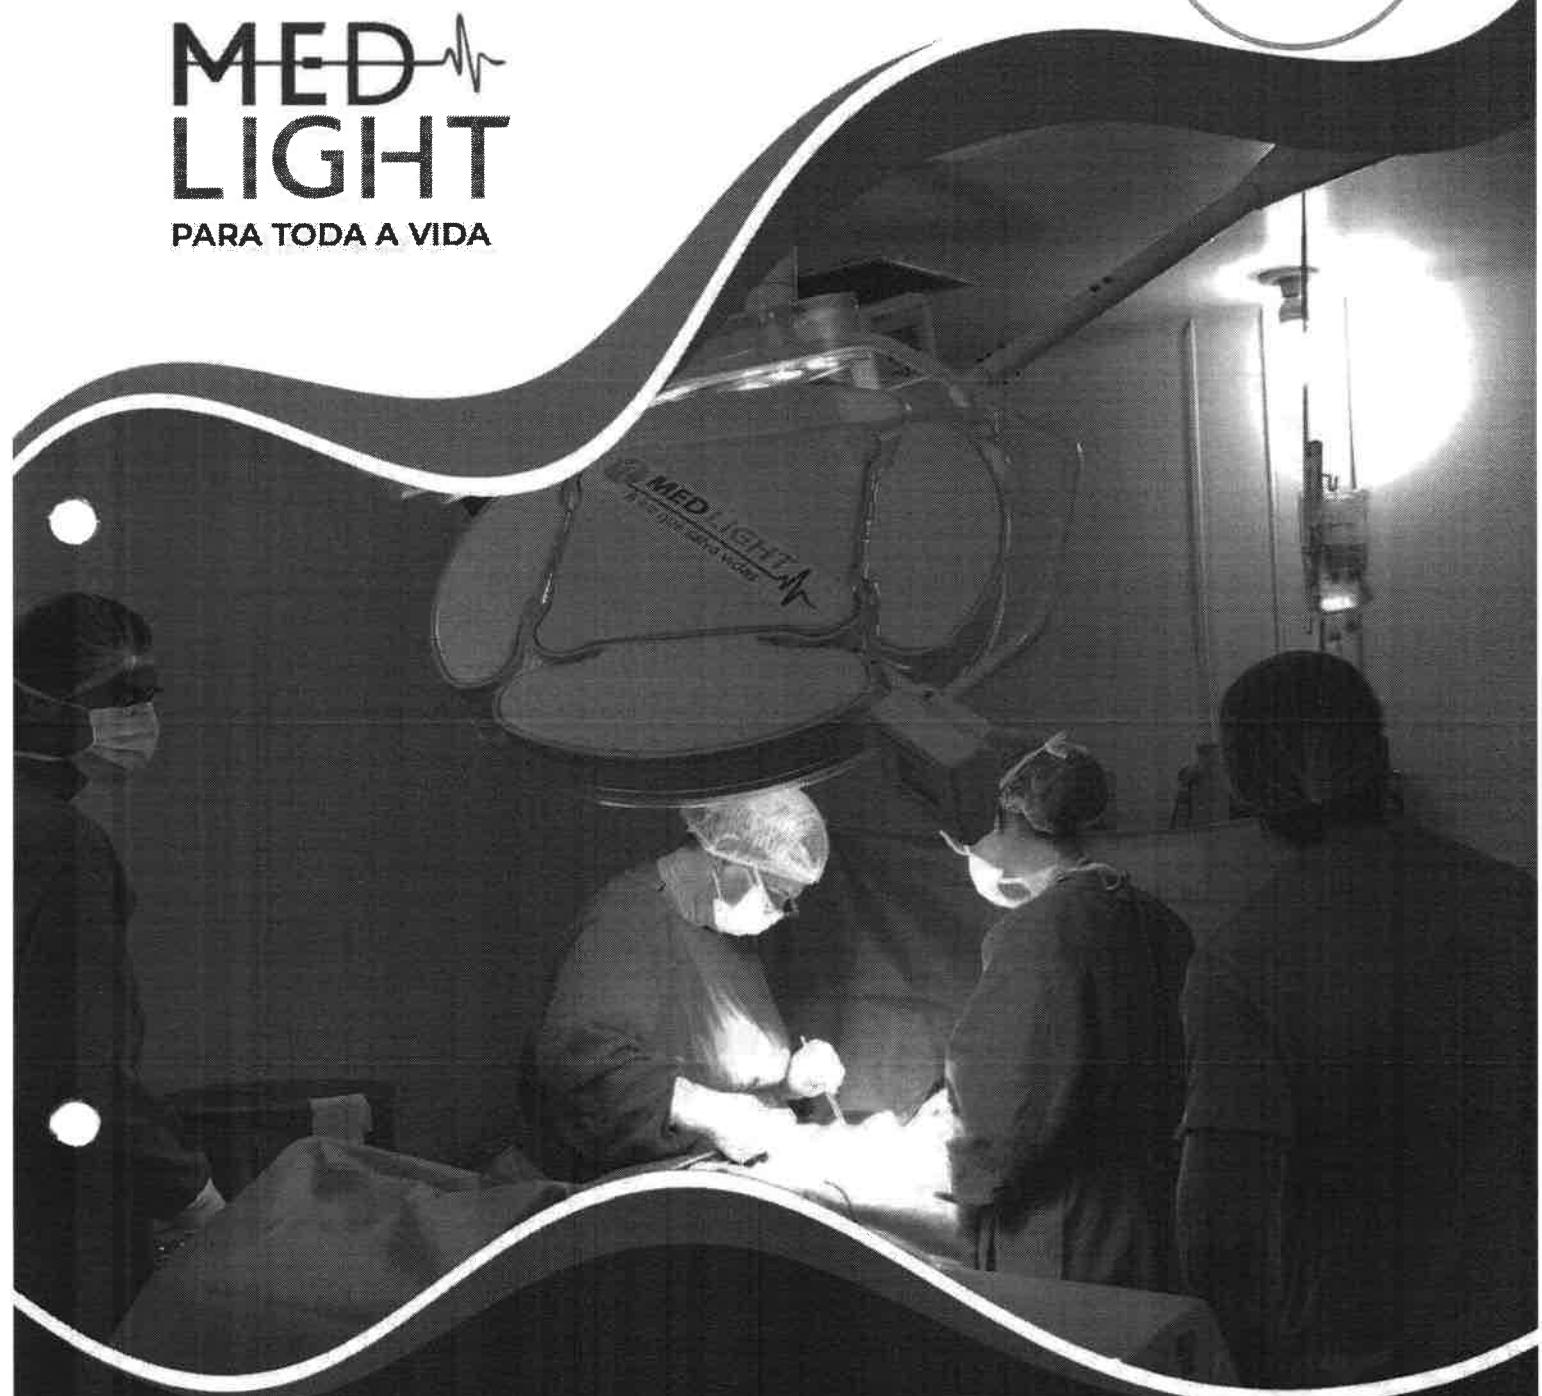

CATÁLOGO DE PRODUTOS

WWW.MEDLIGHT.COM.BR

SOBRE A MEDLIGHT

Localizada na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, a MED LIGHT EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES é uma indústria **100% BRASILEIRA**. Com suas atividades iniciadas há mais de 25 anos, a MED LIGHT projeta, desenvolve e fabrica equipamentos destinados a Centros Cirúrgicos, Unidades de Terapia Intensiva e Internações, para hospitais e clínicas de todo o Brasil.

Conheça um pouco mais da história da MED LIGHT em

www.medlight.com.br

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Nosso compromisso com a qualidade começa com o projeto de nossos produtos. Todos os nossos equipamentos são desenvolvidos por engenheiros altamente qualificados, que, em estreita colaboração com médicos e profissionais da saúde, trabalham para que nossas soluções atendam integralmente, de forma simples e objetiva, às necessidades da equipe médica e seus pacientes.



CONFORMIDADE COM AS NORMAS


Estar em conformidade com as normatizações que regem o setor é fundamental para nós. E por isso, nosso processo produtivo e produtos seguem rígidos padrões de segurança, qualidade e meio ambiente, estabelecidos e atestados, continuamente, pelos órgãos competentes.

FOCOS CIRÚRGICOS




TETO

REGISTRO MS: 80712710009

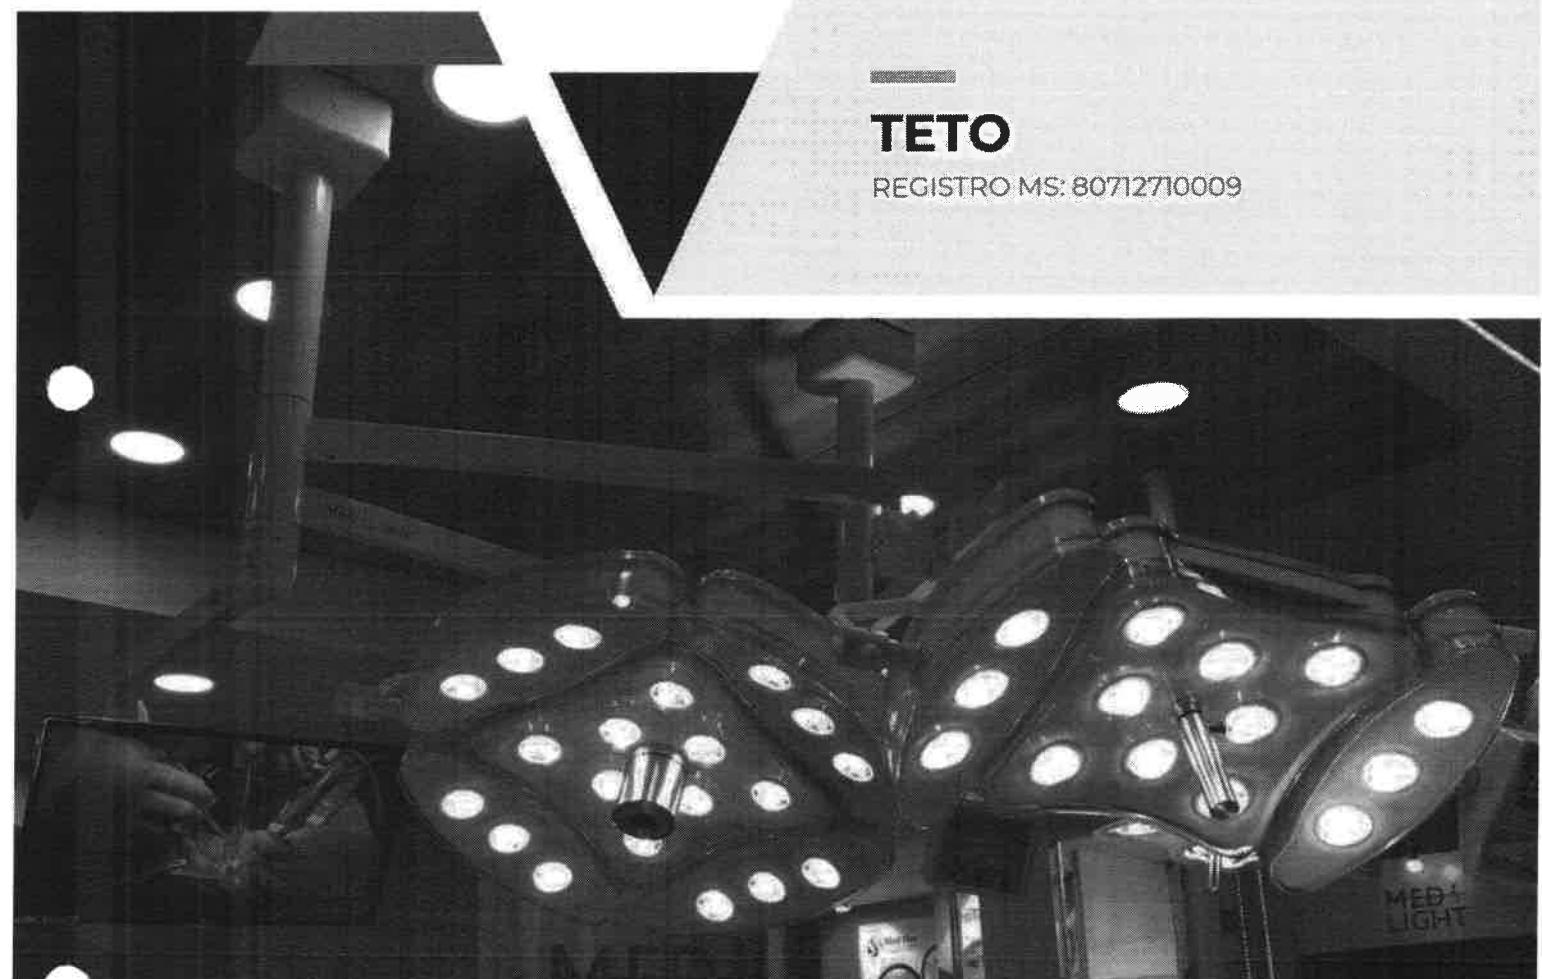

AUXILIARES


REGISTRO MS: 80712710007

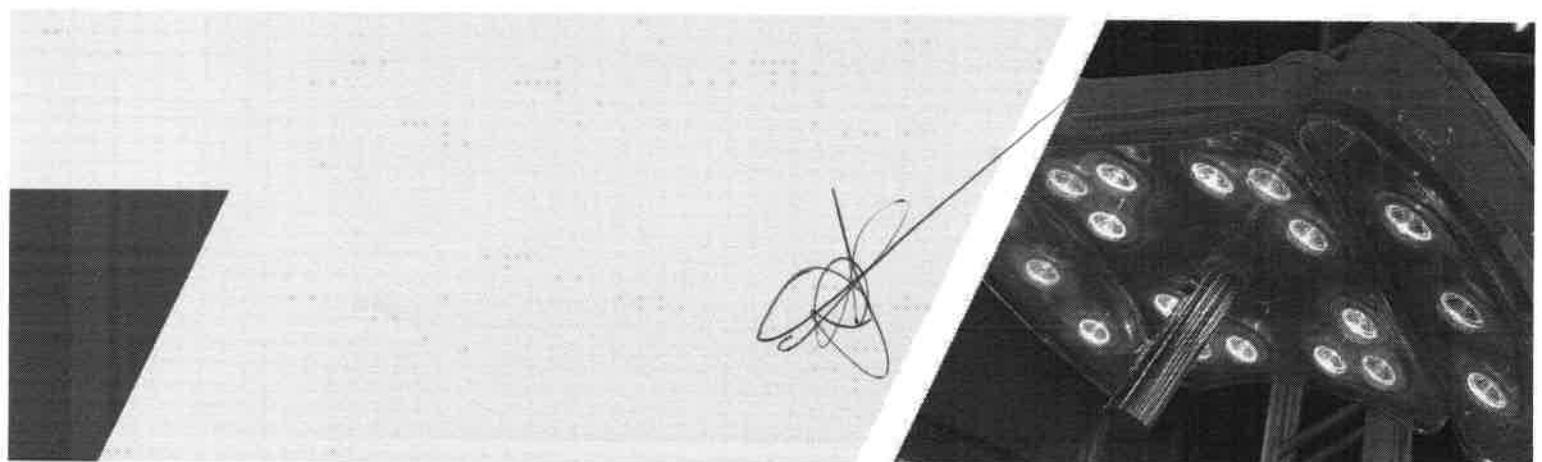

FOCOS CIRÚRGICOS

Nosso foco cirúrgico tem uma proposta de eficiência e tecnologia.

A família de focos Apollo possibilita à equipe clínica uma operação de fácil entendimento e manuseio, através de controles intuitivos e versáteis. Além de possuir um projeto voltado para ter uma manutenção econômica e ágil.

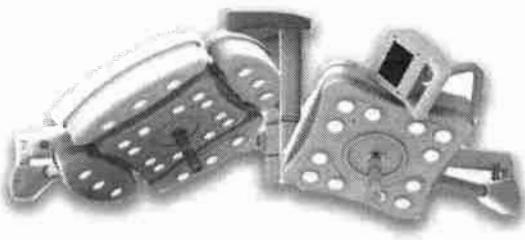

FT APOLLO 200
04 SATELITES x 03/04
BULBOS LED

luminosidade

160 mil LUX

120 mil LUX

luminosidade


140 mil LUX

140 mil LUX

luminosidade

120 mil LUX

120 mil LUX

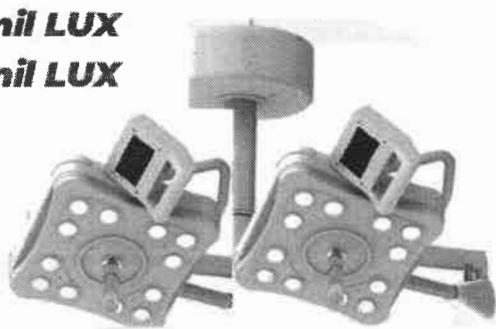

FT APOLLO 200
03/04 x 03/04
BULBOS LED



FT APOLLO 300
02 x 02 SATELITES COM
CÂMERA E MONITOR DE VÍDEO

Através do painel de controle eletrônico localizado na cúpula, é possível ajustar níveis de temperatura de cor e intensidade luminosa. Proporcionando à cada procedimento um campo cirúrgico com uma iluminação adequada a variáveis biológicas e preferências individuais, como por exemplo: estrutura dos diferentes tecidos e a percepção óptica do cirurgião. Uma composição de luz adequada ajuda a concentração, reduz a fadiga, e ofuscamento durante procedimentos mais longos.

Dados Técnicos do Produto

- Painel de Controle com tecnologia Touch Screen
- Ajuste de temperatura de Cor de 3.000k a 6.000k
- Ajuste de Intensidade Luminosa com 10 níveis
- Sistema de Emergência Inteligente (Opcional)
- Manoplas em Alumínio Usinado, Plástico ou Silicone
- Sistema de iluminação em LEDs com vida útil de 120 mil horas.
- LEDs com ligação independente entre si.

► SISTEMA DE EMERGÊNCIA

Sistema inteligente com autonomia de 3 horas até 7 dias conforme manual e monitoramento da carga da bateria em tempo real. O sistema conta ainda com alerta sonoro em caso de falta de energia e indicação luminosa do estado do sistema.


A autonomia do sistema de emergência pode variar em função do modelo da cúpula e a intensidade na utilização. Consulte-nos para mais informações.



► MANOPLA EM ALUMÍNIO

A manopla em alumínio esterilizável, facilmente removível, proporciona segurança da equipe médica e pacientes, minimizando os riscos de infecções e proliferação de bactérias no ambiente cirúrgico.

Confeccionada em alumínio usinado, a resistência e vida útil das manoplas são o nosso diferencial.

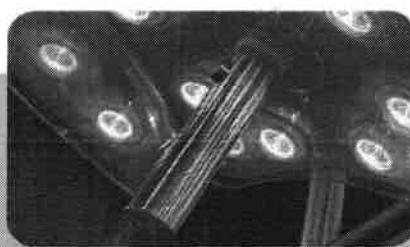

Opcional: versão em plástico ou silicone

► PAINEL DE CONTROLE

Painel de controle com design moderno e display de 4.3 polegadas touch screen para maior usabilidade. Estrutura do painel protegida por membrana de fácil assepsia.

Conta com ajuste de temperatura de cor e intensidade luminosa de até 10 níveis, conforme manual.



CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

► FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO

Os focos cirúrgicos Apollo são dotados de 1, 2 ou 3 braços rotacionais completamente configuráveis com monitor HD de alta resolução, ou cúpulas que podem variar de 80 a 160 mil LUX.

| | FT 100 | FT 200 | FT 300 |
|----------|--------------------------|---|---|
| 1º BRAÇO | 80k / 120k / 140k / 160k | 80k / 120k / 140k / 160k | 80k / 120k / 140k / 160k |
| 2º BRAÇO | - | 80k / 120k / 140k / 160k ou monitor de vídeo | 80k / 120k / 140k / 160k |
| 3º BRAÇO | - | - | 80k / 120k / 140k / 160k ou monitor de vídeo |

► FOCOS CIRÚRGICOS AUXILIARES

Modelo disponível

FA

85k / 120k / 140k / 160k




CÂMERA FULL HD 1080P



Com o avanço da telemedicina, cada vez mais, as instituições médicas e de ensino estão utilizando de novas tecnologias para oferecer experiências cirúrgicas que podem ser acompanhadas à distância.

MED
LIGHT

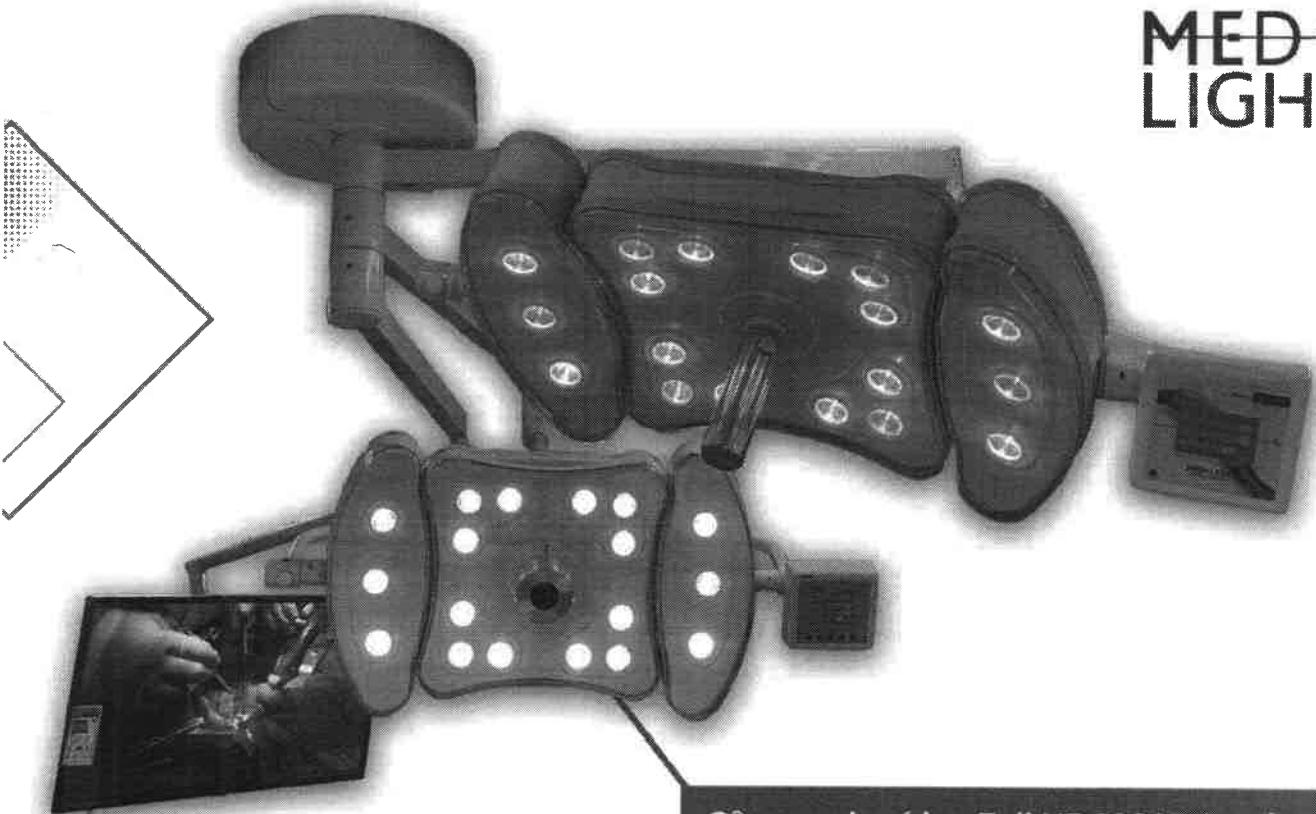

Monitor Grau Médico Full HD 32"
(opcional 50" 4K)

Câmera de vídeo Full HD 1080P (opcional 4K)
Zoom Óptico 20x
Zoom Digital de até 120x

SISTEMA MEDCAST




Armazene e transmita procedimentos cirúrgicos em tempo real, via internet, através de uma solução completa de transmissão de vídeo em alta resolução. O sistema **MEDCast** permite a captura, processamento, armazenamento e transmissão de imagens em alta definição, em tempo real, durante o processo cirúrgico. Tecnologia para toda vida.

ESTATIVAS HOSPITALARES



ESTATIVAS HELPLIFE


REGISTRO MS: 80712710008

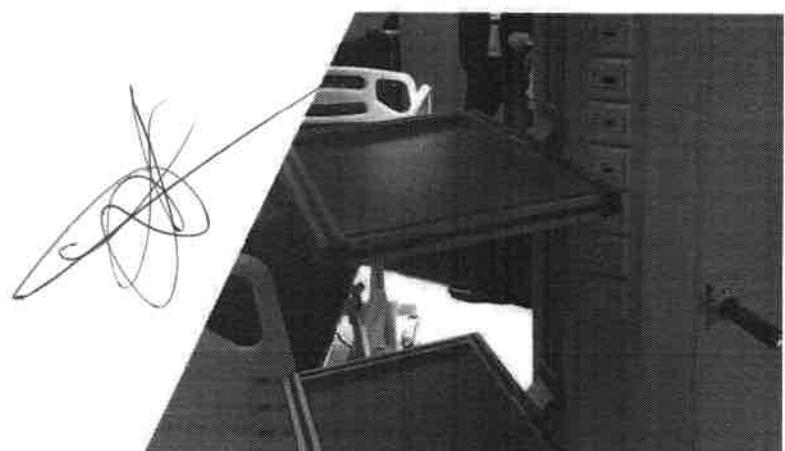



SOBRE O PRODUTO

As estativas hospitalares MED LIGHT desempenham papel fundamental para ergonomia da equipe médica, para a eficiência dos fluxos de trabalho e principalmente, para segurança e prevenção de infecções. Elas permitem o melhor posicionamento possível dos mais diversos equipamentos médicos. Garantem ainda uma conexão segura da redes de dados, de energia e de suprimento de gases medicinais. São totalmente configuráveis, conforme a necessidade do cliente e possuem uma vasta variedade de acessórios disponíveis.

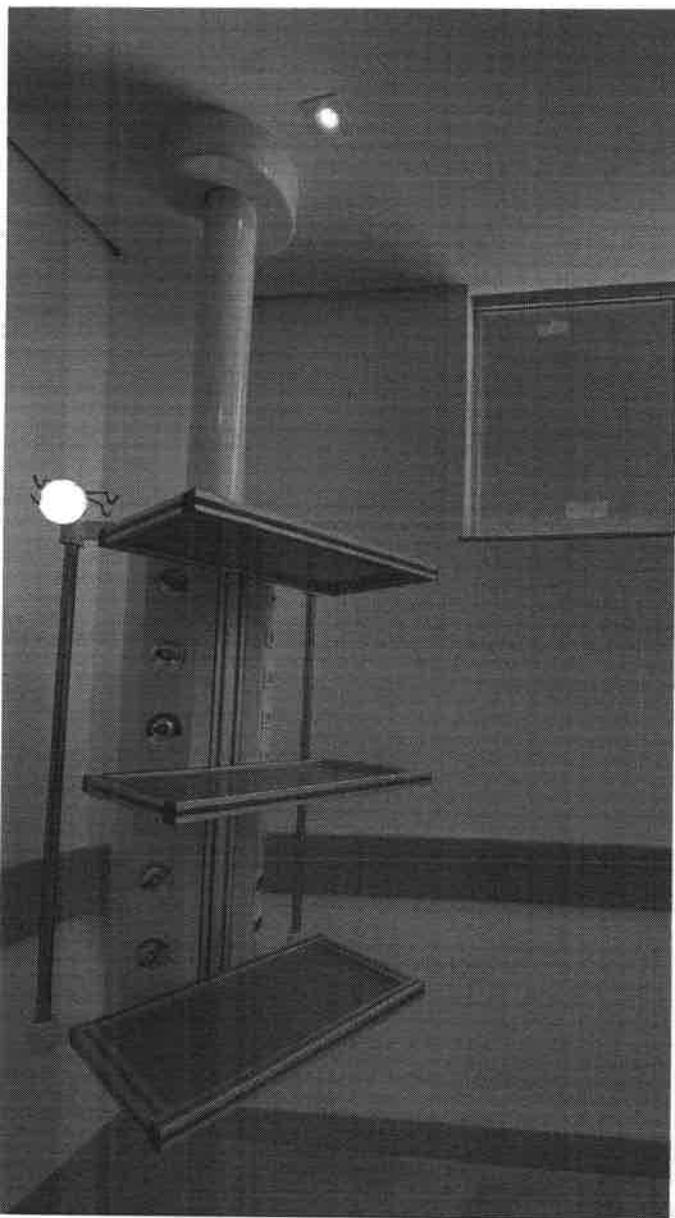


- ▶ Capacidade de até 05 bandejas para acomodação de equipamentos
- ▶ Suporte para até 08 bombas de infusão e até 08 bolsas de soro
- ▶ Conexões elétricas de circuito independentes (sistema IT MEDICO)
- ▶ Conexões de rede, vídeo e de gases medicinais



MED
LIGHT

MÓVEIS HOSPITALARES

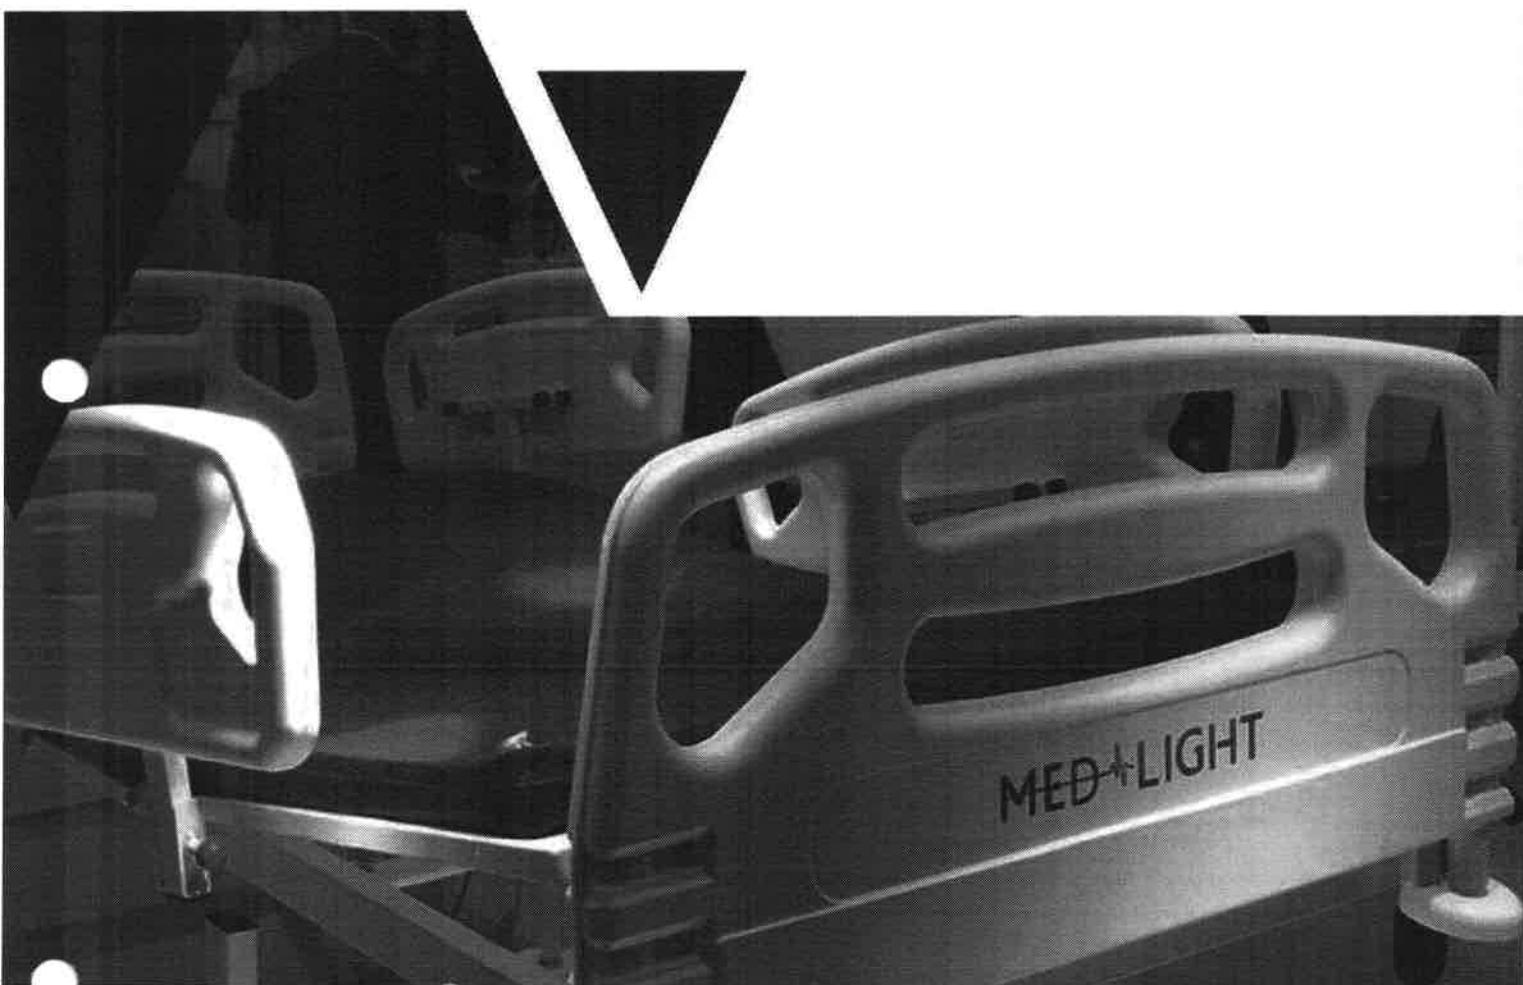


CAMA HOSPITALAR

REGISTRO MS: 80712710003

BERÇO HOSPITALAR

REGISTRO MS: 80712710004

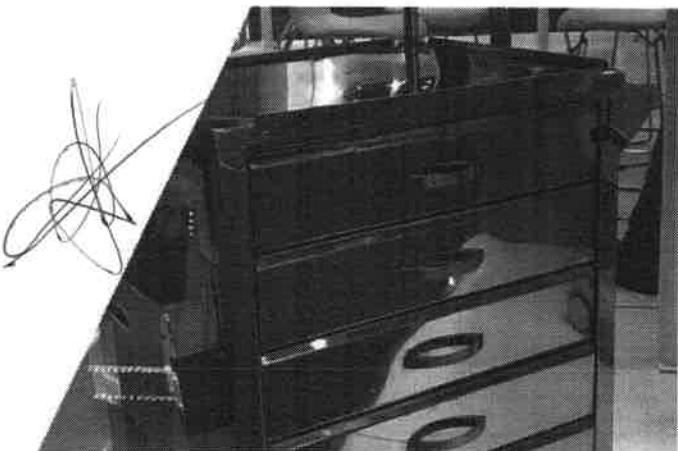

CAMA ELÉTRICA

Capacidade de Carga

300 kg



Bumpers de
Proteção contra
parede

Sistema de recolhimento retrátil
com trava de segurança e
amortecedor pneumático

Grades Laterais em conformidade
com a nova norma NBR IEC60601-2-52,
que prevê medidas de segurança para
o paciente.

Carenagem de Acabamento
Termoplástico de Alto Impacto.
Cabeceira / Peseira Removíveis
em Polietileno de Alta Densidade

Grau de Proteção IP4

Movimentos Realizados



Controles Supervisor
e Manual com Fio



Indicador de
Ângulo do Dorso



Sistema CPR



Rodízios com
freios e travas de
segurança

Dados Técnicos do Produto

Movimentos motorizados

| | |
|-----------------|-------------------|
| Fowler Dorso | 77° de Inclinação |
| Fowler Pernas | 23° de Inclinação |
| Elevação Máxima | 0,75 m |
| Elevação Mínima | 0,50 m |

Leito

Comprimento: 1900 a 2200 mm
Largura: 800 a 1100 mm
Altura Mínima: 510 mm
Altura Máxima: 750 mm

Total

Comprimento: 2000 a 2300 mm
Largura: 900 a 1200 mm
Carga Máxima de Trabalho: 300 kg
Peso Máximo do Paciente: 250 kg

Acessórios Opcionais


- Suporte para soro em aço INOX;
- Suporte para cilindro de oxigênio;
- Grade deslizante em aço INOX;
- Leito em AÇO INOX AISI304;
- Leito em aço carbono liso ou perfurado;
- Indicador de ângulo analógico Dorso Perna e Trendelenburg;
- Movimento de CPR;
- Rodízios de 3" a 10" polegadas;
- Sistema de Freio simultâneo e direcional;
- Bateria de emergência;
- Controle remoto;
- Comando na peseira com bloqueio de função e display;
- Comando de grade vertical;
- Comando de grade horizontal;
- Colchão D33 120mm a 200mm de altura;
- Bumpers protetores de parede nos quatro cantos do leito;
- Balança;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Os equipamentos da MED LIGHT foram pensados para serem reparados de forma simples e rápida, sem a necessidade de retirá-los do local. Minimizando assim o tempo de inatividade e custos adicionais. Contamos com um sistema de assistência técnica remota e assistência técnica autorizada em todo o país.

Nossa equipe de Engenharia coordena e acompanha, em tempo real, a realização de testes diagnósticos e apresenta possíveis soluções de reparo. Caso alguma peça necessite ser substituída, nosso estoque nos permite enviá-la imediatamente até você.

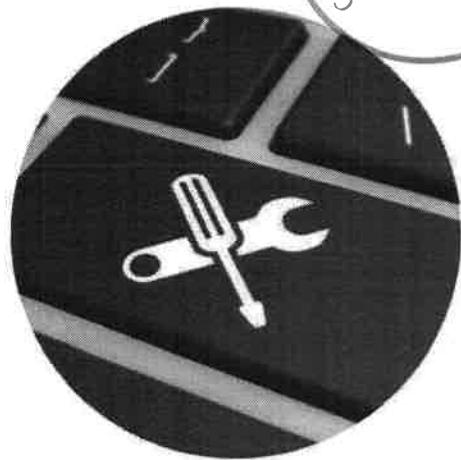

VISÃO, MISSÃO E VALORES



Nossa Missão:

Fabricar equipamentos médicos hospitalares com tecnologia de ponta e qualidade, garantindo acesso ao mercado nacional e contribuir com o desenvolvimento e o crescimento do país no segmento que atua.



Nossa Visão:

Atuar no mercado hospitalar como referência nacional na excelência do atendimento e na qualidade dos produtos para a saúde.



Nossos Valores:

- Honestidade e transparência nas parcerias e relações comerciais
- Satisfação dos clientes internos e externos
- Respeito às pessoas, ao meio ambiente e aos Organismos Regulamentadores

Mais informações em:

www.medlight.com.br



FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

Entre em contato com o time de especialistas da MED LIGHT. Auxiliamos na análise e especificação, dando suporte em todas as etapas do seu projeto.



ESCANEIE O QR-CODE PARA
FALAR COM NOSSOS ESPECIALISTAS



www.medlight.com.br

✉ licitacao@medlight.com.br

📞 (35) 3212-9926 / (35) 98408-0180




📍 Rua do Comércio de Café, 231
Industrial Reinaldo Foresti
Varginha/MG - CEP 37026-530

COMPRESSOR de AR SEM ÓLEO



1200*2 - 50L

- MOTOR DE 2 POLOS - ALTA ROTAÇÃO
- MENOR CONSUMO DE ENERGIA
- MENOR MANUTENÇÃO
- COMPRESSOR MAIS LEVE E SILENCIOSO

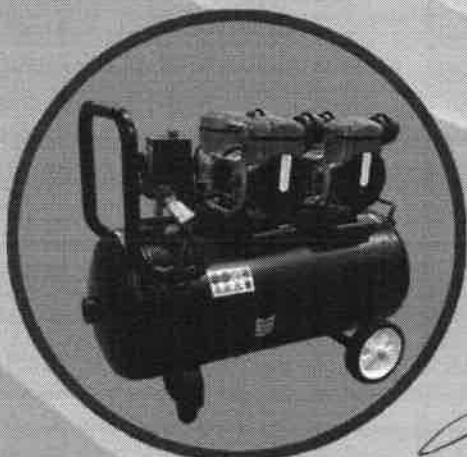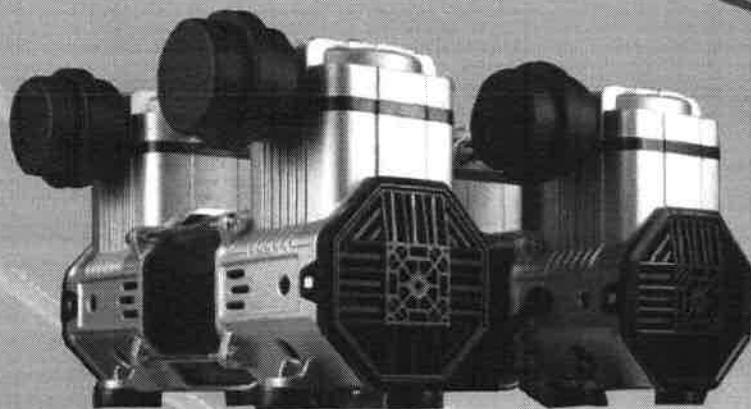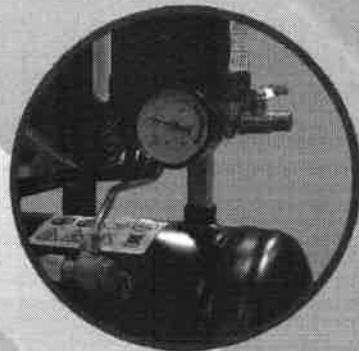

| | |
|----------------|-------------------------|
| Reservatório | 50L |
| Voltagem | 220V |
| Potência | 2,2 HP/850*2W - 2 Pólos |
| Deslocamento | 300L/min |
| Rotação | 3400 rpm |
| Nível de ruído | 70 dba |
| Pressão Máxima | 8,3 BAR |
| Pressão Mínima | 5,5 BAR |
| Peso | 32,20 KG |
| Tamanho | 81 X 32 X 59 cm |

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Reconhecer que o Solicitante/Acknowledge that the Certificate Holder

ARGOTECH Distribuidora de Máquinas Elétrica Unipessoal Ltda

Certificado/Certificate
UL-BR 25.0078

Revisão/Review
00

Emissão/Issue
27 de janeiro de 2025
January 27, 2025

Validade/Expiration
26 de janeiro de 2029
January 26, 2029

Vasos de Pressão / Pressure Vessels

ao qual atende aos requisitos do Programa de Certificação ou Portaria/evaluated and meets the requirements of the Certification Program or Decree

Portaria INMETRO n° 120:2021 / INMETRO Ordinance n° 120:2021

e pode ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado./ and can display the Conformity Identification Seal of the Brazilian Conformity Assessment System (SBAC) on the product(s) listed in this certificate.



Rafael Parada
Program Owner

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029./ UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.0078

Emissão/Issue
27 de janeiro de 2025
January 27, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
26 de janeiro de 2029
January 26, 2029

Solicitante/Certificate holder
Party number: 2354830

ARGOTECH Distribuidora de Máquinas Eletrica Unipessoal Ltda
Av. Presidente Wilson, 5056 – Sala 2
04.220-001 São Paulo - SP - Brasil
CNPJ: 39.922.493/0001-52

Fabricante/Manufacturer
Party number: 2821349

TAIZHOU ZHONGWEI AIR COMPRESSOR MANUFACTURING CO., LTD
Chayu Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City
ZHEJIANG SHENG, CHINA
CNPJ: NA

Modelo de certificação/
Certification model

5

Norma(s) aplicável(is)/
Applicable standards

ABNT NBR ISO 16528-1:2008
ASME VIII Div. I Ed. 2019

Identificação UL/
UL identification

BR4825 / Vol.01 / Sec.01

Identificação da família/modelo/lote de produto(s) certificado(s)/Identification of the family/model/lot of certified product(s):

| Marca/ Brand name | Modelo/ Model | Descrição/ Description | Código de barras/ Bar code number |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ARGOTECH / KRAW | 6L | COMPRESSOR DE AR Modelo 6L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 6L | COMPRESSOR DE AR Modelo 6L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 8L | COMPRESSOR DE AR Modelo 8L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 8L | COMPRESSOR DE AR Modelo 8L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 25L | COMPRESSOR DE AR Modelo 25L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 25L | COMPRESSOR DE AR Modelo 25L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 30L | COMPRESSOR DE AR Modelo 30L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 30L | COMPRESSOR DE AR Modelo 30L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 50L | COMPRESSOR DE AR Modelo 50L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 50L | COMPRESSOR DE AR Modelo 50L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 65L | COMPRESSOR DE AR Modelo 65L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 65L | COMPRESSOR DE AR Modelo 65L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 80L | COMPRESSOR DE AR Modelo 80L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 80L | COMPRESSOR DE AR Modelo 80L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 100L | COMPRESSOR DE AR Modelo 100L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 100L | COMPRESSOR DE AR Modelo 100L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH | 200L | COMPRESSOR DE AR Modelo 200L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH | 200L | COMPRESSOR DE AR Modelo 200L 220 VAC | N/A |

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.0078

Emissão/Issue
27 de janeiro de 2025
January 27, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
26 de janeiro de 2029
January 26, 2029

Lista de Documentos/Documents List:

| <input checked="" type="checkbox"/> Description ILL# | <input type="checkbox"/> TestRef ILL# | Titulo / Title | Desenho Nº | Revisão ou Data: |
|--|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| | | | Drawing No.: | Issue or Date (DD/MM/YYYY) |
| 01 | | Drawing vessel 8 L | BHA 1913 | 00 |
| 02 | | Drawing vessel 25 L | BHA 1910 | 00 |
| 03 | | Drawing vessel 30 L | BHA 1914 | 00 |
| 04 | | Drawing vessel 50 L | BHA 1912 | 00 |
| 05 | | Drawing vessel 65 L | BHA 1916 | 00 |
| 06 | | Drawing vessel 80 L | BHA 1919 | 00 |
| 07 | | Drawing vessel 100 L | BHA 1920 | 0000 |
| 08 | | Drawing vessel 200 L | BHA 1922 | 00 |
| 09 | | Avaliação de famílias | - | - |
| 10 | | Calculation Sheet (Typical) (Ø 350 mm) | BHA1920-00 | R1 |
| 11 | | User Manual | - | - |
| 12 | | Identification Label | ZH-SGQ-001 | 1 |
| 13 | | PVTR ASME VIII Div 1 | BR4865 | 05/08/2020 |
| 14 | | Receiving procedure | ZH-SGQ-001 | Rev A Ed 3 |
| 15 | | Process Inspection | - | A |
| 16 | | Welding inspection | - | A |
| 17 | | Construction Control Manual (MCC) | Ed 1 | R 1 |
| 18 | | Prontuário ao Cliente (Típico) Ver MCC | - | - |
| 19 | | Manual KRAW | ZH – SGQ - 001 | 2 |
| 20 | | KRAW packaging design | - | - |

Informações de ensaios/Test information:

| <input checked="" type="checkbox"/> TestRec DS# | <input type="checkbox"/> TestRef DS# | Titulo/Descrição: Title/Description: | Documento Nº | Revisão ou Data: |
|---|--------------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| | | | Document No.: | Issue or Date (DD/MM/YYYY) |
| 01 | | Welding Procedure Specification (Typical) | WPS-001 | 02/07/2020 |
| 02 | | Welding Procedure Qualification Record | PQR (WPS001) | 02/07/2020 |
| 03 | | Welder Performance Qualification | WPQ001 | 1 |
| 04 | | Welding Operator Qualification | WOPQ W06 | 1 |
| 05 | | Welding Inspector Training Record | BD1601-02 | 11/07/2020 |
| 06 | | Joint Identification Card (JIC) | JIC2007 | 01 |
| 07 | | ISO 9001:2025 Certificate | QM171905042 | 09/05/2019 |
| 08 | | Safety Valve Certificate ASME | 42611 | 18/11/2020 |

Informações de auditoria/Audit information:

| Local da auditoria/Audit location | Data de realização/Perform date |
|--|---|
| Tratamento de reclamações/ Complaint handling | 5 de novembro de 2024 November 5, 2024 |
| Fabricante/ Manufacturer | 19 e 20 de dezembro de 2024 December 19 and 20, 2024 |

Informações adicionais/Additional information:

N/A



Solutions

UL do Brasil Certificações – CNPJ 04.830.102/0001-95
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 – <https://latam.ul.com/>



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado/Certificate: UL-BR 25.0078

Emissão/Issue
27 de janeiro de 2025
January 27, 2025

Revisão/Review: 00

Validade/Expiration
26 de janeiro de 2029
January 26, 2029



Observações/Observations:

1. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro./
The validity of this Certificate of Conformity is linked to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of UL do Brasil Certifications provided for in the specific Conformity Assessment Regulation. To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada (s) acima./
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this certificate.
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado./
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.
4. Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado./
This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.
5. Este certificado cancela e substitui o certificado UL-BR 20.1723.
This certificate cancels and substitutes certificate UL-BR 20.1723.

Histórico de revisões/Revisions history:

| Revisão/ Review | Data/ Date | Descrição da revisão/ Revision description |
|---|---|--|
| 00 | 27 de janeiro de 2025 January 27, 2025 | Project SR.5930776.1487792: Emissão inicial. Atualização de endereço do Solicitante. Este certificado cancela e substitui o certificado UL-BR 20.1723. Initial issue. Address update of Certificate Holder. This certificate cancels and substitutes certificate UL-BR 20.1723. |
| A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones | | |

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

SURVEILLANCE CONFIRMATION



Certificado/
Certificate

UL-BR 20.1723

Data de Emissão da Confirmação/
Confirmation Issue Date

17 de janeiro de 2025
January 17, 2025

Próxima Etapa de Avaliação/
Next Surveillance Step

22 de abril de 2025
April 22, 2025

Solicitante/Certificate Holder
Party number: 2354830

ARGOTECH Distribuidora de Máquinas Eletrica Unipessoal Ltda
Av. Presidente Wilson, 5056 – Sala 2, 04.220-001 São Paulo – SP -
Brasil
CNPJ: 39.922.493/0001-52

Fabricante/Manufacturer
Party number: 2398590

Taizhou Zhongwei Air Compressor Manufacturer co., Ltd
Chayu Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang Sheng,
China

Modelo de Certificação/
Certification Model

5

Produto Certificado/
Certified Product

VASOS DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO / Pressure vessels for
compressed air

Programa de Certificação ou Portaria/
Certification Program or Decree

PORTARIA INMETRO Nº 120, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Etapa da Manutenção/
Surveillance Step

6ª Manutenção – 2º Semestre/2024

Informações de Auditoria/Audit Information

| Local da Auditoria Audit Location | Data de Realização Perform Date |
|---|---|
| Tratamento de Reclamações Complaint Handling | 5 de novembro de 2024 November 5, 2024 |
| Fabricante Manufacturer | 19 & 20 de dezembro de 2024 December 19 & 20, 2024 |

Informações de Ensaios/Test Information

| Laboratório de Ensaios/ Testing Laboratory | Relatório de Ensaios/ Test Report | Data de Emissão/ Issue Date |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| N/A | N/A | N/A |

A identificação da Família / Modelo(s) / Versão(ões) do(s) Produto(s) Certificado(s) encontra(m)-se no Anexo I /
The identification of the Family / Model(s) / Version(s) of the Certified Product(s) can be found in Annex I.

O presente documento confirma a manutenção de sua certificação/
This document confirms the surveillance of your certification.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos/
We are at your disposal for further clarification.

Atenciosamente,
Best Regards,



Rafael Parada
Program Owner

Histórico de Revisões/Revisions History

| Revisão/ Review | Data/ Date | Descrição da Revisão/ Revision Description |
|---|---|---|
| 00 | 17 de janeiro de 2025 January 17, 2025 | Emissão Inicial/Initial issue |
| A última revisão substitui e cancela as anteriores/ The last review replaces and cancels the previous ones | | |

Informações Adicionais/Additional Information

N/A



UL do Brasil Certificações – OCP 0029
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 – 23º Andar
São Paulo – SP – Brasil – 04571-010 – <https://latam.ul.com/>

Anexo I/Attachment I

Identificação(ões) da Família/Modelo(s) pertencente(s) ao Certificado de Conformidade/
Identification(s) of the Family/Model(s) belonging to the Certificate of Conformity



| Marca/ Brand Name | Modelo/ Model | Descrição/ Description | Código de Barras/ Bar Code Number |
|----------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| ARGOTECH / KRAW | 6L | COMPRESSOR DE AR Modelo 6L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 6L | COMPRESSOR DE AR modelo 6L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 8L | COMPRESSOR DE AR modelo 8L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 8L | COMPRESSOR DE AR modelo 8L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 25L | COMPRESSOR DE AR modelo 25L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 25L | COMPRESSOR DE AR modelo 25L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 30L | COMPRESSOR DE AR modelo 30L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 30L | COMPRESSOR DE AR modelo 30L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 50L | COMPRESSOR DE AR modelo 50L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 50L | COMPRESSOR DE AR modelo 50L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 65L | COMPRESSOR DE AR modelo 65L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 65L | COMPRESSOR DE AR modelo 65L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 80L | COMPRESSOR DE AR modelo 80L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 80L | COMPRESSOR DE AR modelo 80L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 100L | COMPRESSOR DE AR modelo 100L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH / KRAW | 100L | COMPRESSOR DE AR modelo 100L 220 VAC | N/A |
| ARGOTECH | 200L | COMPRESSOR DE AR modelo 200L 127 VAC | N/A |
| ARGOTECH | 200L | COMPRESSOR DE AR modelo 200L 220 VAC | N/A |

Ministério da
SaúdeÓrgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade

Entrar com gov.br

家 > Setor Regulado > Regularização de produtos e serviços > Produtos para saúde > Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 11/09/2024 16h52

Compartilhe:


Atualizado em 24/07/2024



CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL




1 Afinador de navalhas para micrótomo

CONTÉUDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5



5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)
 - a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrifuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - a. Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

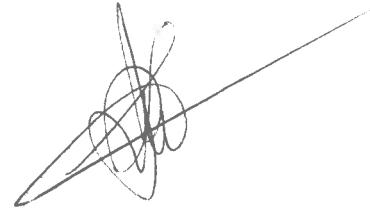

≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa



- 35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 36. Digestor
- 37. Diluidor de amostras
- 38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
- 40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 41. Equipamento para gerenciamento de amostras
- 42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
- 43. Espectrofômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos
- 46. Evaporador centrífugo a vácuo
- 47. Fermentador de culturas
- 48. Filtro para soluções
- 49. Forno mufla
- 50. Fotômetro de chama
- 51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 55. Indicador físico, químico ou biológico
- 56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
- 57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 58. Lenço para assepsia da pele
- 59. Liofilizador
- 60. Luxímetro
- 61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 63. Medidor do ponto de fusão
- 64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa




69. Montadores automáticos de lâminas e lâminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



~ CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojo, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)

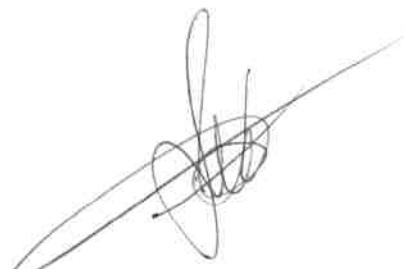

≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa



10. Caldeira
11. Caneta para marcação cirúrgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir suporte de soro e/ou painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper



☰ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa



41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

3. Simulador de funções fisiológicas para ensino



CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças, exceto as de bioimpedância destinadas para terapia ou diagnóstico em saúde.
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese



≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

35. Secador e escova de cabelos

36. Top maternal, Sling

37. Aparelho Para Perfuracao e Colocacao de Brincos




CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

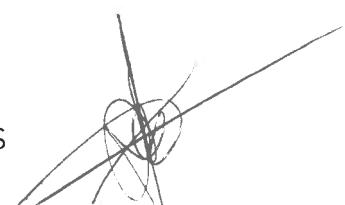

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de



≡ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc. 
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe:    